





DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Jum'at, 11 November 2022
 Waktu : 13.00 WIB - selesai
 Tempat : Ruang Aula lt. 3A
 Acara : Training Penggunaan LAF

No.	Nama	Bagian	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Fajar Satriyo	✓ OK	Manager	
2.	Haris Sugiharto FICOPRI	IPS	Elektrone dis	
3.	Ibu	✓ farmasi	Manager	
4.	OTTO DESYANTO	LPDT	Manager	
5.	Aji Galih	Ravit Inap	Pesawat.	
6.	Rizal Maulana	✓ PPI	IPCN	
7.	Dian Widya	R. Inap	Pesawat	
8.	Arista Sulisti	R. Inap.	Pesawat.	
9.	Yeni Agustina	✓ Farmasi	Staff	
10.	YUYUN RAHMADIAN	✓ FARMASI	STAF	
11.	Ahy Darmayanti	✓ farmasi	staff	
12.	Syahma Ramy	Farmasi	STAF	
13.	Yessika Melita. P	✓ farmasi	staff	
14.	Amin	✓ Farm	Staf	
15.	Fendi Setiyanto	✓ Farmasi	staff	
16.	Fisman	Labs	staff	

PROTAP PENGGUNAAN LAMINAR FLOW CABINET

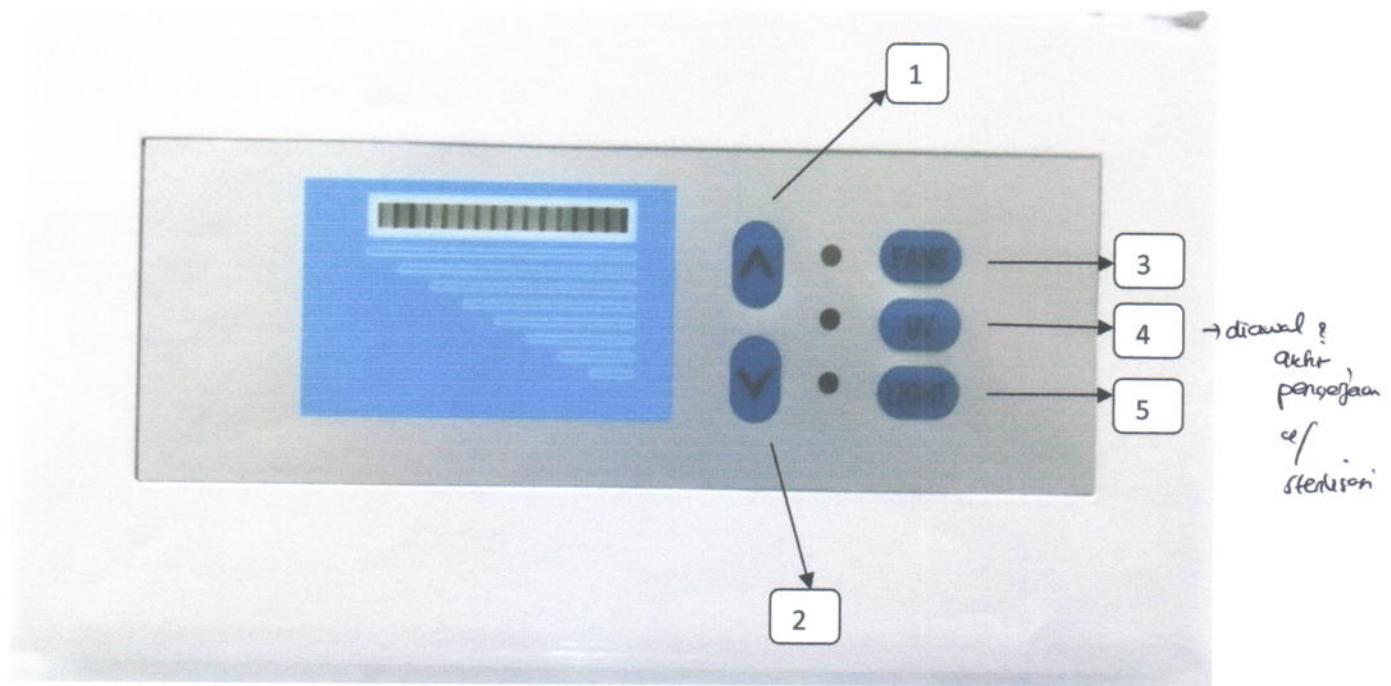

Fungsi Tombol

1. Menaikkan kecepatan blower.
2. Menurunkan kecepatan blower.
3. Menghidupkan dan mematikan blower.
4. Menghidupkan dan mematikan lampu UV.
5. Menghidupkan dan mematikan lampu penerangan.

Prosedur menghidupkan alat

- Lakukan proses sterilisasi dengan menekan tombol UV.
- Biarkan lampu UV menyala selama ±30 menit. ✓
- Setelah 30 menit, matikan lampu UV.
- Buka jendela kaca hingga ketinggian yang di inginkan.
- Hidupkan blower/kipas, biarkan selama ±30 menit.
- Atur speed sesuai kebutuhan (antara 0.3 hingga 0.5 m/s).
- Setelah 30 menit, nyalakan lampu penerangan dan alat siap untuk digunakan.

Prosedur mematikan alat.

- Matikan blower / kipas.
- Tutup jendela ke bawah hingga rapat.
- Matikan lampu penerangan.
- Nyalakan lampu UV, biarkan selama 30 menit.
- Setelah 30 menit matikan lampu UV

Perawatan.

- ✓ Periksa fungsi kerja dari masing masing tombol.
- ✓ Bersihkan kaca jendela dan permukaan meja kerja dari cipratan dan kotoran dengan menggunakan kain yang dibasahi dengan alkohol 70%.
- ✓ Selalu pantau kecepatan udara dalam rentang nilai antara 0.3 – 0.5 m/S.
- ✓ Tinggalkan ruangan kerja ketika sedang dilakukan sterilisasi dengan lampu UV.

\$ Selamat Bekerja \$