

Lembar Disposisi

Surat diterima tanggal : 14 November 2022

Kepada Yth. : Direktur

Wadir Pelayanan

Wadir Administrasi, Umum dan Keuangan

Kabag/Kabid/Kainst/Kasubag.....

Dari :

Direktur :

Tanggal :

Wadir Pelayanan :

Tanggal :

Sehup tindak lanjut PO v/ pembelian troli emergency
v/ Rawat inap ty vendor PT-MCA. TKS
Ju HIKT

Wadir Administrasi, Umum dan Keuangan :

Tanggal :

Kabag/Kabid/Kainst/Kasubag..... :

Tanggal :



NOTULEN

TANGGAL : Senin, 14 November 2022
WAKTU : 10.00 WIB - selesai
TEMPAT : Ruang Rapat 1 Lt. 3b
AGENDA RAPAT :
PEMIMPIN RAPAT :
NOTULIS :
JUMLAH PESERTA :
TIDAK HADIR :
PEMBAHASAN : pengadaan trolley emergency.

- ① trolley emergency → seri Z ET 501
- ② free kunci disposable, 1 pack, bawaan dan alat 1 pack.
- ③ pembelian → barang datang, uji fungsi dan label → layanan bayar.
- ④ Harga. e katalog ada PPN jadi Rp 10.999.100.
- ⑤ garansi 1 th include garansi spare part.
- ⑥ barang ready.
- ⑦ pembuatan PO.

Surabaya, 10 September 2022

Nomor : 003/RSMU/FAR/IX /2022
Lampiran : -
Perihal : Evaluasi DEMO Trolley Emergency

Yth. GENERAL MEDIS PENUNJANG dan YANMED Rs. Mata Surabaya
di Surabaya

Dengan hormat bersama ini, kami sampaikan hasil Demo Microsurgery yang dilaksanakan sejak tanggal 09 September sampai 10 September 2022 di Instalasi Rawat Inap + Kamar Operasi (oleh PT IHS) dan PT Internusa Dua Medika dengan resume hasil Demo sebagai Berikut :

NO	KEGIATAN	HASIL DEMO	KETERANGAN
1	PT MCA	1. Spesifikasi bagus, tidak ada tempat utk monitor patient 2. Ukuran alat kecil	Harga Rp. 13.155.054
X	PT IHS	1. Spek bagus 2. Terlalu besar 3. Sdh dipake di IGD	Harga Rp.19.758.000
X	PT polaris / MAK	Menolak DEMO, pembelian diminta melalui E-Katalog	hargaRp.23.576.400

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Hormat kami,
Ka.Instalasi Farmasi,



Intan Kusumawati, S.Farm, Apt., MARS.


Mengetahui,

GM Penunjang Medis



Zainal Arifin, A.Md, PK

GM Pelayanan Medis



Zwei Sujanto, Skep, Ns

Catatan :

Sesuai dengan demo unit Rany
Memilih produk dari MCA

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id



**RS MATA
UNDAAN**

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
PERMINTAAN BARANG MEDIS NON RUTIN**

UNIT : R. Inap.

TANGGAL : 10/8/22.

NO	NAMA BARANG	MEREK	NO. KATALOG	JUMLAH	PERKIRAAN HARGA	KONDISI BARANG LAMA
1.	Trolly emergency v/ premium.	MDK		1	Rp. 20.000.000	-
2.	Vital sign monitor			1	Rp. 20.000.000	
3.	beban per sign x obat pembersih			1		

Menyetujui
Ka. Unit

Mengetahui,
Ka. Wadiv Yan-Medik
GTA Perawatan

Zully Bagas Syanto

~~Ka. Wadiv Yan-Medik~~
Ka. Wadiv Yan-Medik

Ka. Ins Farmasi

(Intan Kusumawati)



**RSMATA
UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya
Telp. 031 5343806 , 5319619, Fax. 031 5317503

Formulir Hasil Trial Perbekalan Farmasi

Tanggal Trial : 10 September 2022

Nama User : Mochammadli

Nama Principal / Distributor : PT. Mimar Citra Abadi (MICA)

Alamat Principal / Distributor : _____

Telp. HP Principal / Distributor No : _____

Nama Produk	Tipe	Penawaran Harga	Fitur Unggulan
Emergency Trolley	ZETFU		

Penjelasan Hasil Trial :

pasang pengaman tempat monitor,
 - tidak ada tempat untuk fixasi monitor,
 - spesifikasi layer / sayangnya bisa di
 hasil ERF

* Lingkari pada pilihan Yes / No
Rekomendasi User terhadap Produk :

Yes No

NAMA & PARAF

Ri

Catatan Lain : pasang pengaman monitor

Formulir Hasil Trial Perbekalan Farmasi

 Tanggal Trial : 10 September 2022

 Nama User : mill-annandita

 Nama Principal / Distributor : PT. Mimar Citra Abadi (MICA)

Alamat Principal / Distributor : _____

Telp. HP Principal / Distributor No : _____

Nama Produk	Tipe	Penawaran Harga	Fitur Unggulan
<u>Emergency Trolley</u>	<u>ZET 50</u>		



 Penjelasan Hasil Trial : ~~Pasang Pajangan di ruang monitor~~

- tidak ada tempat untuk pemasangan monitor
- spesifikasi logis / ~~saat ini~~ ~~tidak dapat~~
- hasil IFS

* Lingkari pada pilihan Yes / No

Rekomendasi User terhadap Produk :

 Yes No

 NAMA & PARAF



 Catatan Lain : pasangan pengaman monitor



**RS MATA
UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya
Telp. 031 5343806 , 5319619, Fax. 031 5317503

Formulir Hasil Trial Perbekalan Farmasi

Tanggal Trial : 10 September 2022

Nama User : AGUYISYAH

Nama Principal / Distributor : PT. Mimer Citra Abadi (MCA)

Alamat Principal / Distributor : _____

Telp. HP Principal / Distributor No : _____

Nama Produk	Tipe	Penawaran Harga	Fitur Unggulan
<u>Emergency Trolley</u>	<u>ZET501</u>		

Penjelasan Hasil Trial : Tidak ada tempat dijumpai untuk penguraian perisurgen monitor.

* Lingkari pada pilihan Yes / No
Rekomendasi User terhadap Produk :

Yes No

NAMA & PARAF

AGUYISYAH

Catatan Lain :

- Dibantu tempat pengaman monitor 1

Formulir Hasil Trial Perbekalan Farmasi

Tanggal Trial : 10 September 2022

Nama User : AGLIYIS YAH

Nama Principal / Distributor : PT. MIMIR Citra Abadi (MICA)

Alamat Principal / Distributor : _____

Telp. HP Principal / Distributor No : _____

Nama Produk	Tipe	Penawaran Harga	Fitur Unggulan
<u>Emergency Trolley</u>	<u>ZE+501</u>		

Penjelasan Hasil Trial :

Tidak ada tempat pengisian
diperlukan untuk program perawatan monitor.

* Lingkari pada pilihan Yes / No

Rekomendasi User terhadap Produk :
 Yes
 No

NAMA & PARAF

AGLIYIS YAH

Catatan Lain :

Diperlukan tempat/pengisian monitor yang...



Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya
Telp. 031 5343806 , 5319619, Fax. 031 5317503

Formulir Hasil Trial Perbekalan Farmasi

Tanggal Trial : 10 September 2022

Nama User : ADAM MALIK

Nama Principal / Distributor : PT. Mimar Citra Abadi (MCA)

Alamat Principal / Distributor : _____

Telp. HP Principal / Distributor No : _____

Nama Produk	Tipe	Penawaran Harga	Fitur Unggulan
<u>Emergency Trolley</u>	<u>2x501</u>		

Penjelasan Hasil Trial : tidak ada tempat / penempatan monitor , dengan ukuran kecil . (tidak terdapat Bracket) u/ fiksasi

* Lingkari pada pilihan Yes / No
Rekomendasi User terhadap Produk :

Yes

No

NAMA & PARAF
Adam Malik

Catatan Lain : di lanjutkan pasang pengaman monitor

Formulir Hasil Trial Perbekalan Farmasi

Tanggal Trial : 10 September 2022

Nama User : DAM MALIK

Nama Principal / Distributor : PT. MIMAR Citra Abadi (MICA)

Alamat Principal / Distributor : _____


Telp. HP Principal / Distributor No : _____

Nama Produk	Tipe	Penawaran Harga	Fitur Unggulan
<u>Emergency Trolley</u>	<u>ZET 501</u>		

Penjelasan Hasil Trial : tidak ada tempat pemasangan monitor dengan ukuran kecil (tidak terdapat Bracket) & finish

* Lingkari pada pilihan Yes / No
Rekomendasi User terhadap Produk :

Yes **No**

NAMA & PARAF


Catatan Lain : di lapangan pasang pengaman monitor



**RSMATA
UNDAAN**

Jl. Undaan Kulon No. 17 - 19 Surabaya
Telp. 031 5343806 , 5319619, Fax. 031 5317503

Formulir Hasil Trial Perbekalan Farmasi

Tanggal Trial : 10 September 2022

Nama User : RUMI

Nama Principal / Distributor : PT. Mimar Citra Abadi (MCA)

Alamat Principal / Distributor : _____

Telp. HP Principal / Distributor No : _____

Nama Produk	Tipe	Penawaran Harga	Fitur Unggulan
<u>Emergency Trolley</u>	<u>ZER501</u>		

Penjelasan Hasil Trial : terdapat kendala dibantu untuk pemasangan monitor

* Lingkari pada pilihan Yes / No
Rekomendasi User terhadap Produk :

Yes No

NAMA & PARAF

[Signature]

Catatan Lain : Dibantu u/ pemasangan pemadangan monitor

Formulir Hasil Trial Perbekalan Farmasi

Tanggal Trial : 10 September 2022

Nama User : RUMI

Nama Principal / Distributor : PT. Mimar Cita Abadi (MCA)

Alamat Principal / Distributor : _____

Telp. HP Principal / Distributor No : _____

Nama Produk	Tipe	Penawaran Harga	Fitur Unggulan
<u>Emergency Trolley</u>	<u>ZETA 1</u>		

Penjelasan Hasil Trial :

terdapat terdapat dibantu untuk pengaman
dan tawaran monitor

* Lingkari pada pilihan Yes / No

Rekomendasi User terhadap Produk :

Yes No

NAMA & PARAF


[Signature]

Catatan Lain :

di bantu pengaman pemantauan monitor



DIMENSI (mm) ±

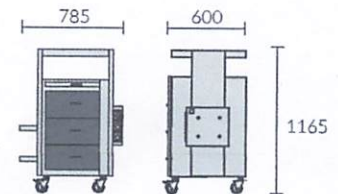

SPEKIFIKASI

Konstruksi

Terbuat dari baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.

Bagian / Terdiri

- 3 laci
- Laci khusus (terbuat dari lembaran stainless steel)
- Rak atas

Aksesoris

- Tiang infus stainless steel, bisa diatur ketinggiannya..
- Dudukan tabung oksigen
- 3 buah stop kontak, kabel dan jack
- Panel RJP, di bagian belakang troli

Castor

Castor 5" + pelindung benturan (bumper)

Finishing

Cat oven (epoxy powder coating)

Berat Produk

± 54 kg

Dimensi

± (P)785 x (L)600 x (T)1165 mm (keseluruhan).
± (P)500 x (L)500 x (T)725 mm (pada box).



LACI KHUSUS

Multifungsi untuk penyimpanan alat-alat medis



KUNCI SEGEL

Laci dilengkapi dengan segel untuk penjamin kelengkapan medis yang dibutuhkan



STOP KONTAK

Dilengkapi dengan stop kontak untuk memudahkan penggunaan alat-alat medis selama prosedur perawatan




CASTOR

Dilengkapi dengan castor 5" untuk memudahkan pergerakan trolley

EMERGENCY TROLLEY ZET501



DIMENSI (mm) ± :

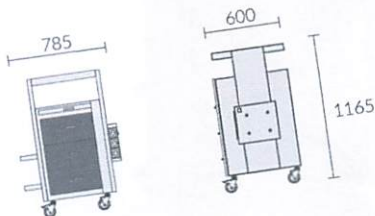


PRODUCT NAME
EMERGENCY TROLLEY

CATALOG NO
ZET501

SERIAL NUMBER
1912695010000001

KEMENKES RI
AKD XXXXXXXXXXXX

SPESIFIKASI

Konstruksi	Konstruksi terbuat dari baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
Bagian/ Terdiri	- 3 laci. - Laci khusus (terbuat dari lembaran stainless steel). - Rak atas.
Aksesoris	- Tiang Infus stainless steel, bisa diatur ketinggiannya. - Dudukan tabung oksigen. - 3 buah stop kontak, kabel dan jack. - Panel RJP, di bagian belakang troli.
Kastor	Kastor 5" + pelindung benturan (bumper).
Finishing	Cat Oven
Berat Produk	± 54 kg.
Dimensi	± (P)785 x (L)600 x (T)1165 mm (keseluruhan). ± (P)500 x (L)500 x (T)725 mm (pada box)

Diproduksi oleh :
PT. MEGA ANDALAN KALASAN
YOGYAKARTA - INDONESIA

Didistribusikan oleh :
PT. BUANA INTIPRIMA MEDIKA
Rukan Sentra Niaga Blok F No. 3
Green Lake City, Duri Kosambi,
Cengkareng, Jakarta Barat.

No. Reg. Kemenkes RI AKD No :

LACI KHU


Multifungsi ur
alat medis



EMERGENCY TROLLEY ZET501



DIMENSI (mm) ± :

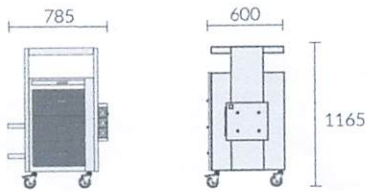

 <small>Made in Indonesia</small>	PRODUCT NAME EMERGENCY TROLLEY	CATALOG NO ZET501
	SERIAL NUMBER 1912695010000001	KEMENKES RI AKD XXXXXXXXXXXX

SPESIFIKASI

Konstruksi	Konstruksi terbuat dari baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
Bagian/ Terdiri	<ul style="list-style-type: none"> - 3 laci. - Laci khusus (terbuat dari lembaran stainless steel). - Rak atas.
Aksesoris	<ul style="list-style-type: none"> - Tiang Infus stainless steel, bisa diatur ketinggiannya. - Dudukan tabung oksigen. - 3 buah stop kontak, kabel dan jack. - Panel RJP, di bagian belakang troli.
Kastor	Kastor 5" + pelindung benturan (bumper).
Finishing	Cat Oven
Berat Produk	± 54 kg.
Dimensi	± (P)785 x (L)600 x (T)1165 mm (keseluruhan). ± (P)500 x (L)500 x (T)725 mm (pada box)

Didistribusikan oleh :
PT. BUANA INTIPRIMA MEDIKA
 Rukan Sentra Niaga Blok F No. 3
 Green Lake City, Duri Kosambi,
 Cengkareng, Jakarta Barat.

Diproduksi oleh :
PT. MEGA ANDALAN KALASAN
 YOGYAKARTA - INDONESIA

No. Reg. Kemenkes RI AKD No :





**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



LAMPIRAN

**NOMOR IZIN EDAR
ALAT KESEHATAN
KEMENKES RI AKD 10404020706**

No.	Deskripsi	Tipe / Kode
1	Tiang Infus Stainless Steel	BP034K000C
2	Dudukan Tabung Oksigen	A0004H001B
3	Stop Kontak	D0010F001B
4	Panel RJP	OMPWD00024

Dengan ketentuan bahwa izin edar tersebut hanya berlaku untuk deskripsi dan tipe / kode produk yang tercantum dalam lampiran ini

Jakarta, 19 Mei 2020



Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan ini diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan :

NOMOR IZIN EDAR

ALAT KESEHATAN

KEMENKES RI AKD 10404020706

Nama Dagang / Merek : **ZELOS Emergency Trolley ZET501**
Kelompok / Kelas Resiko : Non Elektromedik Non Steril / A
Kategori Produk : Peralatan Anestesi
Sub Kategori : Peralatan Anestesi Lainnya
Jenis Produk : Anesthetic cabinet, table, or tray
Tipe / Ukuran : ZET 501
Kemasan : karton
Nama Produsen / Pabrikan : PT. MEGA ANDALAN KALASAN, DI Yogyakarta
Nama Pendaftar : PT. BUANA INTIPRIMA MEDIKA, DKI Jakarta
Atas dasar lisensi dari : -

Ketentuan

1. Persetujuan izin edar berlaku sampai dengan 23 Januari 2025.
2. Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku.
3. Produsen hanya boleh menyalurkan produknya melalui Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
4. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar.
5. Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini.
6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

Jakarta, 19 Mei 2020



Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



PT. MIMAR CITRA ABADI

Jl. Manyar Mertoarjo III/93 Surabaya
031-59177930
pt.mimarcitraabadi@gmail.com

Surabaya, 12 Agustus 2022

Nomor : 116/SPH/MCA/VII/2022
Perihal : Surat Penawaran Harga
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.:
Direktur
Rumah Sakit Mata Undaan
Jl. Undaan Kulon No. 19, Peneleh
Kec. Genteng
Di
Surabaya

Dengan Hormat,

Kami PT. MIMAR CITRA ABADI selaku distributor alat-alat kesehatan dan alat Laboratorium menawarkan barang sesuai dengan kebutuhan di Rumah Sakit Mata Undaan dengan rincian sebagai berikut :

NO	Nama Barang	HNA	HNA+PPN
1	ZELOS Emergency Trolley ZET 501	Rp 11.851.400	Rp 13.155.054 ✓
2	ZELOS Emergency Trolley ZET 502	Rp 25.812.600	Rp 28.651.986
3	ZELOS Emergency Trolley ZET503	Rp 30.067.400	Rp 33.374.814
4	ABN Vital Sings Monitor VM 100 Mobile	Rp 29.025.920	Rp 32.218.771
5	ABN Vital Sings Monitor VM 100 Desk	Rp 25.773.660	Rp 28.608.763

Ket:

1. Harga Sudah termasuk PPn 11%
2. Harga Sudah termasuk biaya kirim

Bersama dengan surat penawaran ini, kami lampirkan brosur dari produk yang kami tawarkan.

Demikian Surat Pernawaran ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

PT. MIMAR CITRA ABADI



15/22 NB: **A** Emergency trolley

1. Apakah bisa di demakan tipe ZET 501, perhitungannya ukuran lebih kecil dan bisa ditempatkan di lorong VIP (mudah dijangkau)
2. Discarb dan pembayaran ?
3. Garansi ?
4. apakah dibungkusnya dgn kunci & segel ?

B Vital SIGNS Monitor

1. Sebaiknya di demakan dulu
2. pilih teknisi yg tersedia di Surabaya dan spare part mudah dicari.

C Emergency trolley Ploxa (PT Polaris Allos Starindo)



Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan ini diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan :

NOMOR IZIN EDAR

ALAT KESEHATAN

KEMENKES RI AKD 10404020706

Nama Dagang / Merek : **ZELOS Emergency Trolley ZET501**
Kelompok / Kelas Resiko : **Non Elektromedik Non Steril / A**
Kategori Produk : **Peralatan Anestesi**
Sub Kategori : **Peralatan Anestesi Lainnya**
Jenis Produk : **Anesthetic cabinet, table, or tray**
Tipe / Ukuran : **ZET 501**
Kemasan : **karton**
Nama Produsen / Pabrikan : **PT. MEGA ANDALAN KALASAN, DI Yogyakarta**
Nama Pendaftar : **PT. BUANA INTIPRIMA MEDIKA, DKI Jakarta**
Atas dasar lisensi dari : **-**

Ketentuan

1. Persetujuan izin edar berlaku sampai dengan 23 Januari 2025.
2. Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku.
3. Produsen hanya boleh menyalurkan produknya melalui Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
4. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar.
5. Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini.
6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

Jakarta, 19 Mei 2020



Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



LAMPIRAN

**NOMOR IZIN EDAR
ALAT KESEHATAN
KEMENKES RI AKD 10404020706**

No.	Deskripsi	Tipe / Kode
1	Tiang Infus Stainless Steel	BP034K000C
2	Dudukan Tabung Oksigen	A0004H001B
3	Stop Kontak	D0010F001B
4	Panel RJP	OMPWD00024

Dengan ketentuan bahwa izin edar tersebut hanya berlaku untuk deskripsi dan tipe / kode produk yang tercantum dalam lampiran ini

Jakarta, 19 Mei 2020



Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1


Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

EMERGENCY TROLLEY ZET501



DIMENSI (mm) ± :

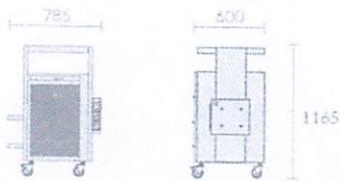

	PRODUCT NAME EMERGENCY TROLLEY	CATALOG NO ZET501
SERIAL NUMBER 1912695010000001		KEMENKES RI AKD XXXXXXXXXXXXX

SPESIFIKASI

Konstruksi	Konstruksi terbuat dari baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
Bagian/ Terdiri	- 3 laci. - Laci khusus (terbuat dari lembaran stainless steel). - Rak atas.
Aksesoris	- Tiang Infus stainless steel bisa diatur ketinggiannya. - Dudukan tabung oksigen. - 3 buah stop kontak, kabel dan jack. - Panel RJP di bagian belakang trolley.
Kastor	Kastor 5" + pelindung benturan (bumper).
Finishing	Cat Oven.
Berat Produk	± 54 kg.
Dimensi	± (P)785 x (L)600 x (T)1165 mm (keseluruhan). ± (P)500 x (L)500 x (T)725 mm (ada box)

Didistribusikan oleh :
PT. BUANA INTIPRIMA MEDIKA
Rukan Sentra Niaga Blok F No. 3
Green Lake City, Duri Kosambi,
Cengkareng, Jakarta Barat.

Diproduksi oleh :
PT. MEGA ANDALAN KALASAN
YOGYAKARTA - INDONESIA

No. Reg. Kemenkes RI AKD No :





**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan ini diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan :

NOMOR IZIN EDAR

ALAT KESEHATAN

KEMENKES RI AKD 10404020577

Nama Dagang / Merek : **ZELOS Emergency Trolley ZET502**
Kelompok / Kelas Resiko : Non Elektromedik Steril / A
Kategori Produk : Peralatan Anestesi
Sub Kategori : Peralatan Anestesi Lainnya
Jenis Produk : Anesthetic cabinet, table, or tray
Tipe / Ukuran : ZET 502
Kemasan : KARTON
Nama Produsen / Pabrikan : PT. MEGA ANDALAN KALASAN, DI Yogyakarta
Nama Pendaftar : PT. BUANA INTIPRIMA MEDIKA, DKI Jakarta
Atas dasar lisensi dari : -

Ketentuan

1. Persetujuan izin edar berlaku sampai dengan 23 Januari 2025.
2. Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku.
3. Produsen hanya boleh menyalurkan produknya melalui Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
4. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar.
5. Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini.
6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

Jakarta, 04 Mei 2020



Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSIe.



LAMPIRAN

NOMOR IZIN EDAR
ALAT KESEHATAN
KEMENKES RI AKD 10404020577

No.	Deskripsi	Tipe / Kode
1	Tiang Infus	D0044N001C
2	Dudukan Tabung Oksigen	D0044J000C
3	Panel RJP	0MPWD00084

Dengan ketentuan bahwa izin edar tersebut hanya berlaku untuk deskripsi dan tipe / kode produk yang tercantum dalam lampiran ini


Jakarta, 04 Mei 2020




Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

EMERGENCY TROLLEY ZET502

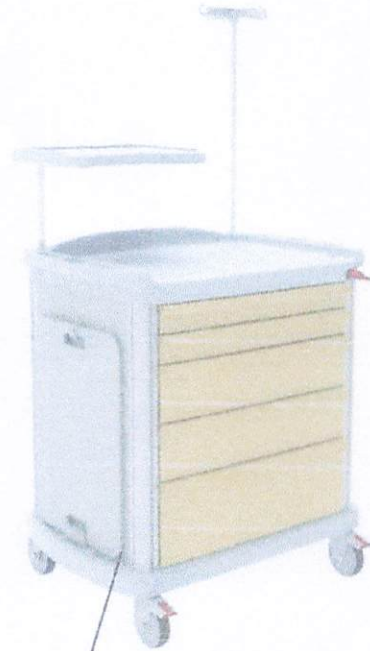

DIMENSI (mm)



SPESIFIKASI

Konstruksi	Secara keseluruhan dari bahan ABS dan material logam, diproduksi dengan menggunakan teknologi terkini.
Bagian/Terdiri	- 5 laci ABS dengan pengunci terpusat (central lock system). - Meja atas dari bahan ABS- bisa ditungkan sebagai handel pendorong. - Meja Defibrilator. - Stop kontak, kabel dan jack.
Aksesoris	Panel resusitasi jantung dan paru,udukan tabung oksigen, tiang infuse.
Kastor	4 roda kastor 5" roda tunggal (2 buah dilengkapi sistem pengunci).
Finishing	Epoxy powder coating (cat oven).
Beban Maksimal	± 100 kg (total).
Berat Produk	± 45 kg.
Dimensi	± (P)915 x (L)615 x (T)1000 mm (keseluruhan). ± (P)750 x (L)550 x (T)700 mm (pada box)

Didistribusikan oleh :
PT. BUANA INTIPRIMA MEDIKA
Rukan Sentra Niaga Blok F No. 3
Green Lake City, Duri Kosambi,
Cengkareng, Jakarta Barat.

Diproduksi oleh :
PT. MEGA ANDALAN KALASAN
YOGYAKARTA - INDONESIA

No. Reg. Kemenkes RI AKD No :





Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan ini diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan :

NOMOR IZIN EDAR
ALAT KESEHATAN

KEMENKES RI AKD 10404020578

Nama Dagang / Merek : **ZELOS Emergency Trolley ZET503**
Kelompok / Kelas Resiko : **Non Elektromedik Steril / A**
Kategori Produk : **Peralatan Anestesi**
Sub Kategori : **Peralatan Anestesi Lainnya**
Jenis Produk : **Anesthetic cabinet, table, or tray**
Tipe / Ukuran : **ZET 503**
Kemasan : **KARTON**
Nama Produsen / Pabrikan : **PT. MEGA ANDALAN KALASAN, DI Yogyakarta**
Nama Pendaftar : **PT. BUANA INTIPRIMA MEDIKA, DKI Jakarta**
Atas dasar lisensi dari : **-**

Ketentuan

1. Persetujuan izin edar berlaku sampai dengan 23 Januari 2025.
2. Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku.
3. Produsen hanya boleh menyalurkan produknya melalui Penyalur Alat Kesehatan (PAK).
4. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar.
5. Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini.
6. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

Jakarta, 04 Mei 2020



Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.




LAMPIRAN

NOMOR IZIN EDAR
ALAT KESEHATAN
KEMENKES RI AKD 10404020578

No.	Deskripsi	Tipe / Kode
1	Tiang Infus	D0044N001C
2	Dudukan Tabung Oksigen	D0044J000C
3	Panel RJP	0MPWD00084

Dengan ketentuan bahwa izin edar tersebut hanya berlaku untuk deskripsi dan tipe / kode produk yang tercantum dalam lampiran ini

Jakarta, 04 Mei 2020

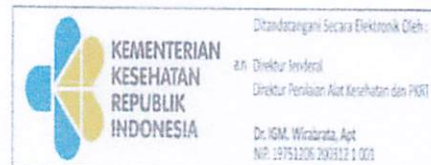


Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI.

EMERGENCY TROLLEY ZET503



DIMENSI ± (mm)

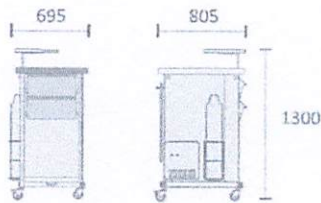

SPESIFIKASI

Konstruksi	Dibuat dari lembaran baja berkualitas, diproses dengan teknologi manufaktur terkini.
Bagian/Terdiri	<ul style="list-style-type: none"> - 5 laci (dengan penguncian terpusat sekaligus sebagai pemotong segel laci). - 2 laci multi fungsi (posisi samping trolley). - Dudukan mesin suction pump. - Meja atas. - Meja defibrilator. - Terminal listrik.
Aksesoris	Tiang infuse stainless steel, Keranjang Tabung Oksigen, Papan RJP.
Kastor	4 roda kastor diameter 5" roda tunggal (2 buah dilengkapi sistem pengunci). Semua roda dilengkapi dengan bumper.
Finishing	Epoxy powder coating (cat oven).
Beban Maksimal	± 100 kg (keseluruhan).
Berat Produk	± 95 kg.
Dimensi	<ul style="list-style-type: none"> ± (P)805 x (L)695 x (T)1300 mm (keseluruhan). ± (P)750 x (L)595 x (T)900 mm (pada box).

Didistribusikan oleh :
PT. BUANA INTIPRIMA MEDIKA
 Rukan Sentra Niaga Blok F No. 3
 Green Lake City, Duri Kosambi,
 Cengkareng, Jakarta Barat.

Diproduksi oleh :
PT. MEGA ANDALAN KALASAN
 YOGYAKARTA - INDONESIA

No. Reg. Kemenkes RI AKD No :



Nomor : 0019/IHSG CAB SBY II/ VIII / 2022
Perihal : Surat Penawaran Harga
Lampiran :-

Surabaya, 15 Agustus 2022

Kepada Yth:
RS. MATA UNDAAN
Jl. Undaan Kufon 19
Surabaya

Dengan hormat,

Bersama ini kami PT. Intisumber Hasil Sempurna Global (IHSG) sebagai distributor alat kesehatan, kedokteran dan laboratorium berskala Nasional, OneStop Shopping, dengan harga kompetitif, barang selalu tersedia, dan pengiriman cepat, bermaksud ingin memberikan penawaran harga beberapa produk yang kami distribusikan, diantaranya sebagai berikut :

No	Produk dan Ukuran	Merk	Harga	ket	Netto
1	EMERGENCY TROLLEY PLUS W/ LOCK INDOMED SET	Indomed	19.758.000	ecat	19.758.000
2	VITAL SIGN MONITOR AM ONE + PRINTER 1SET	Analogic M	13.000.000	ecat	13.000.000
3	PASIEN MONITOR S1200	Analogic M	18.480.000	ecat	18.480.000

Keterangan.

- * Harga sudah termasuk PPN 11%
- * Harga sudah termasuk Ongkos kirim
- * Harga berlaku 30 hari sejak penawaran ini dibuat

Besar harapan kami untuk dapat menerima tanggapan positif dari Bapak/Ibu, kami juga menyediakan dukungan apabila membutuhkan demo atau sample terkait produk yang kami tawarkan, untuk itu berikut kami sertakan Contact Person yang dapat dihubungi sewaktu-waktu sebagai berikut :

Bp. Rulla 0852-5855-4944

Bp. Hari 0811-3544-574

Demikian penawaran ini kami buat, atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan Terimakasih.

Hormat kami,
PT. Intisumber Hasil
Sempurna Global



Rully Apriyanto
Kepala Sales Office



Etalase
Produk



Login

Beranda Pengumuman Berita Informasi Unduh Tanya Jawab Hubungi Kami

Home > Alat Kesehatan > Peralatan Anestesi > Peralatan Anestesi Lainnya > Emergency Trolley with IV Pole


INDOMED EMERGENCY TROLLEY WITH IV POLE

4815000062-AK1-000874657

PT. KARYA INDAH MEDIKA

Katalog Sektoral

Fasilitas Kesehatan



Rp 19.946.700,00

INDOMED Emergency Trolley With IV Pole

Spesifikasi

Lampiran

Referensi Ongkos Kirim

Diskusi Produk

searching e. catalog

(1) WhatsApp x E-Katalog 5.0 x E-Katalog 5.0 x E-Katalog 5.0 x +

https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/1250611?y... Cari

ecatalogue
Belanja Cepat Cara Tepat

Etalase Produk Login

Beranda Pengumuman Berita Informasi Unduh Tanya Jawab Hubungi Kami

Home > Alat Kesehatan > Peralatan Kardiologi > Peralatan Kardiologi Pemantauan > AM One Vital Signs Monitor

ANALOGIC MEDICAL AM ONE VITAL SIGNS MONITOR

4815000199-AK1-000881406


PT Jayamas Medica Industri

Katalog Sektoral

Fasilitas Kesehatan

Rp 13.000.000,00

Spesifikasi Lampiran Referensi Ongkos Kirim Diskusi Produk

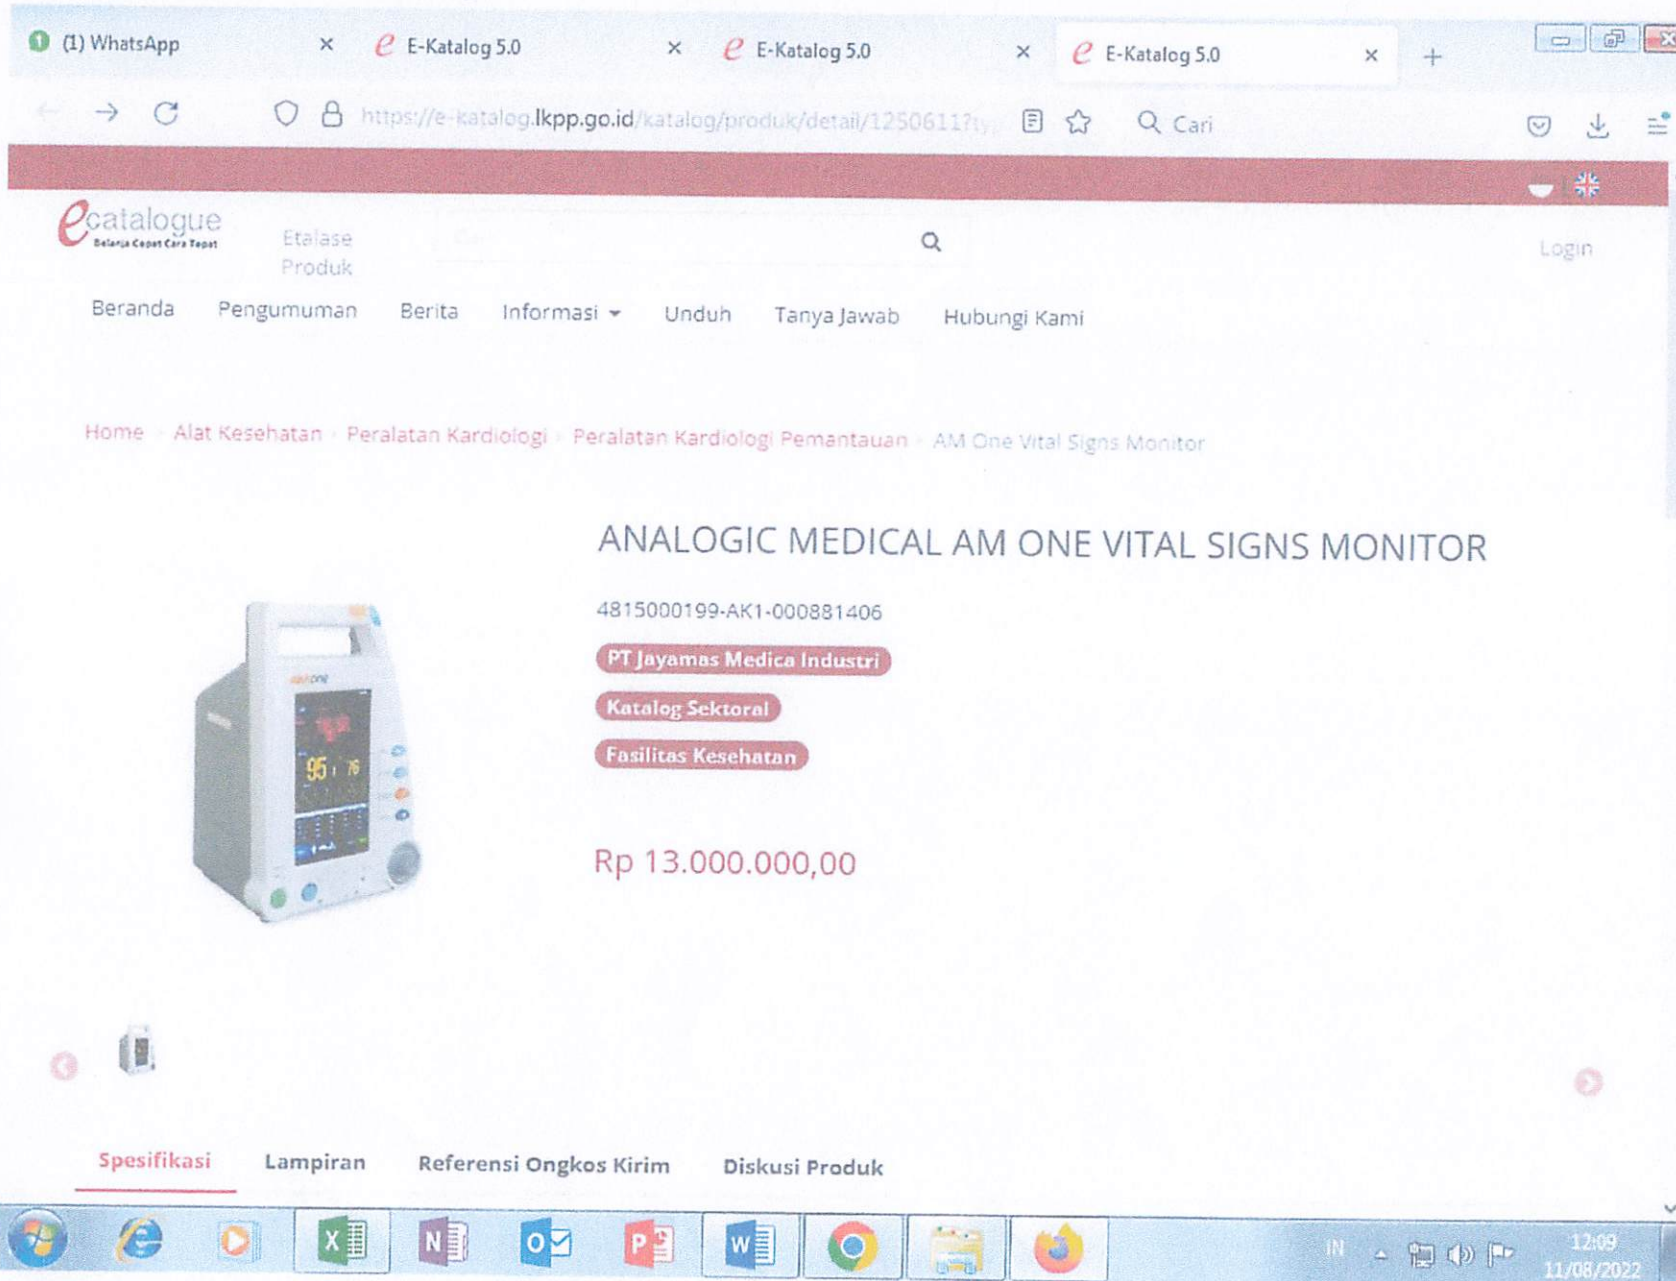

Searching e. catalog

The screenshot shows a web browser window with multiple tabs for 'E-Katalog 5.0'. The address bar shows the URL 'https://e-katalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/1249341'. The page header includes the 'e-catalogue' logo and navigation links like 'Beranda', 'Pengumuman', 'Berita', 'Informasi', 'Unduh', 'Tanya Jawab', and 'Hubungi Kami'. The main content area features a red emergency trolley with an IV pole. To the right of the image, the product name 'INDOMED EMERGENCY TROLLEY WITH IV POLE' is displayed, along with the ID '4B1500062-AK1-00074657', the manufacturer 'PT. KARYA INDAH MEDIKA', and the price 'Rp 19.946.700,00'. Below the product image, there are tabs for 'Spesifikasi', 'Lampiran', 'Referensi Ongkos Kirim', and 'Diskusi Produk'. The 'Spesifikasi' tab is active, showing a table with the following details:

Spesifikasi	Lampiran	Referensi Ongkos Kirim	Diskusi Produk
Nama Produk			
Masa Berlaku Produk			
Merek			
No. Produk Penyedia			


This screenshot shows the 'Spesifikasi Produk' section of the product page. It contains a table with the following specifications:

Unit Pengukuran	Unit
Jenis Produk	PDN
Kode KBKI	481500062
Nilai TKDN(%)	Tidak Ada
Nomor Izin Edar	AKD 10903510407
Nama Perusahaan	PT. KARYA INDAH MEDIKA
Pabrik	PT. KARYA INDAH MEDIKA
Model / Type	-
Nomor Izin Edar (AKD/AKL/Lainnya)	AKD 10903510407
Jenis Produk Sesuai Izin Edar	Cardiopulmonary emergency cart
Fungsi	Untuk menempatkan perlengkapan medis dan obat-obatan penting dan yang dibutuhkan segera
Negara Asal Produk	Indonesia
Negara Pabrik	Indonesia
Spesifikasi Produk Secara Singkat	Dimensi : 64.5 x 49.3 x 102 ± 2 cm (P x L x T)

Indomed

EMERGENCY TROLLEY

With IV Pole

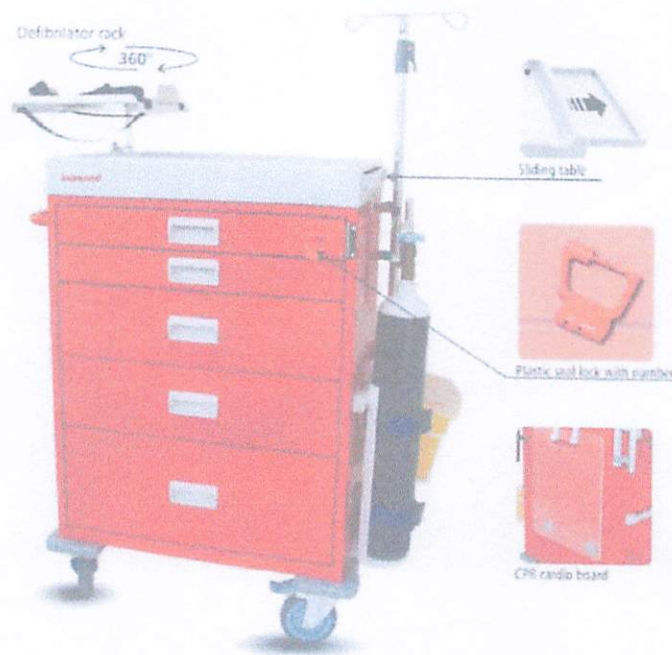

SPESIFIKASI

Merek	: Indomed
Bahan Body	: Steel powder coating, warna merah
Bahan Bagian atas	: Plastik ABS
Dimensi	: 64.5 x 49.3 x 102 ± 2 cm (PxLxT)
Roda	: 4 buah roda, diameter 5 inch

FITUR & AKSESORIS

- Push handle
- Sliding table
- Standard Infus Stainless Steel
- CPR Cardio board
- Defibulator Rack
- Tempat tabung O2, tidak termasuk tabung O2
- 5 buah drawer/laci dengan auto return
 - 2 buah ukuran 3 inch
 - 2 buah ukuran 6 inch
 - 1 buah ukuran 9 inch
- Sharp container set
- Central key lock ✓
- Plastik seal lock with number



PT. Polaris Alkes Starindo

Improve Your Health Quality

Nomor : 050/PAS-PV/VIII/2022
Hal : Penawaran Harga
Lampiran : Brosur

Jakarta, 15 Agustus 2022

Kepada Yth.

Direktur Rumah Sakit Mata Undaan
Jl. Undaan Kulon No.19, Peneleh,
Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur 60274

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami PT Polaris Alkes Starindo sebagai agen dan distributor produk alat kesehatan bermaksud memberikan penawaran harga sebagai berikut.

No	Nama Produk	Merk	Type	Harga Satuan	Harga Setelah Diskon
1	Flexa Emergency Cart	Wecare	FL03	39,294,000	23,576,400

Adapun ketentuan yang berlaku dalam penawaran harga di atas adalah :

1. Harga sudah termasuk PPN 11%
2. Franko Rumah Sakit Mata Undaan
3. Garansi untuk produk Wecare adalah 3 (tiga) tahun
4. Pembayaran 100% sebelum barang dikirimkan
5. *Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.*

Kami mengharapkan penawaran harga di atas dapat diterima dengan baik. Kami menunggu kabar baik dari Bapak/Ibu dalam waktu dekat ini.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Rahmawan Aldrin

National Sales Manager

CP : Danang Denyawan (0857-4700-0043)

FLEXA EMERGENCY CART

FL03



SPESIFIKASI

Konstruksi

Secara keseluruhan dari bahan ABS dan lembaran baja yang diproduksi dengan menggunakan teknologi terkini.

Bagian/Terdiri

- Satu buah laci ukuran tinggi 225 mm.
- Dua buah laci ukuran tinggi 150 mm.
- Dua buah laci ukuran tinggi 75 mm.
- Sistem pengunci sentral untuk mengunci laci secara bersamaan. Hendel pengunci sentral berfungsi juga sebagai pemotong *disposable plastic seals*.
- Meja ABS, digunakan juga sebagai hendel dorong dan bumper.
- Meja Defibrilator.
- Stop kontak, kabel, dan jack.

Aksesoris

Panel resusitasi jantung dan paru, Dudukan tabung oksigen, Tiang infuse.

Castor

4 castor 5" roda tunggal, dua diantaranya menggunakan pengunci.

Finishing

Epoxy powder coating (cat oven).

Beban Maks.

± 100 kg (total).

Berat Produk

± 45 kg.

Dimensi

± (P)915 x (L)615 x (T)1000 mm (keseluruhan).
± (P)750 x (L)530 x (T)700 mm (pada box).



STOP KONTAK & TEMPAT TABUNG OKSIGEN

Untuk penyediaan tenaga listrik alat-alat medis yang diperlukan. Dudukan tabung oksigen untuk ukuran 1m³.



MEJA ATAS

Bagian atas meja menggunakan ABS, ringan dan mudah dibersihkan, yang sekaligus berfungsi sebagai hendel dorong.



MATERIAL


Mayoritas komponen terbuat dari bahan ABS, menghasilkan produk yang lebih ringan, kuat, dan meminimalkan kebisingan saat mobilitas.



HENDEL PENGUNCI & PEMOTONG SEGEL

Laci dengan pengunci sentral, untuk keamanan pengoperasian seluruh laci selama penggunaan.

DIMENSI ± (mm)



Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Eff. Date 05-05-2021

Jakarta, 06 Januari 2021

Kepada Yth :

PELANGGAN PRODUK MAK

Di

Indonesia



No. 05/SK/2021

HAL. : PERUBAHAN DISTRIBUTOR MAK

Dengan Hormat,

Bersama Surat ini kami beritahukan Perubahan Exclusive Distributor Produk MAK Hospital Equipment di Indonesia :

PT. POLARIS ALKES STARINDO



HEAD OFFICE

Jl. Gunung Sahari Raya No. 12 G

Jakarta 10720 - Indonesia

Ph. +62-21-2600 994-95

Fax. +62-21-6008 455

Email : pt.polarisalkesstarindo@gmail.com

PIC. : Rahmawan Aldrin - 0855 1227 987

Jika ada informasi lain yang dibutuhkan terkait perubahan Distributor tersebut dapat menghubungi Marketing Office kami di Jakarta.

Demikianlah pemberitahuan dari kami sehubungan adanya perubahan Distributor MAK di Indonesia mohon maklum adanya.

Atas Perhatian dan Kerjasamanya kami ucapkan banyak Terima Kasih

Hormat Kami

PT. Mega Andalan Kalasan



Surjiasan Ilijas

Direktur

PT MEGA ANDALAN KALASAN

MARKETING OFFICE

Gran Rubina Business Park Lt. 22C,

Komp. Rasuna Epicentrum,

Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta

Indonesia 12940

t. (+62) 21 - 837 00 555

FACTORY

Jl. Tanjung Tirto 34,

Tirtomartani km 13,

Yogyakarta, Indonesia 55571

t. (+62) 274 - 497 069



SURAT PENUNJUKAN

No. 297/SK/2020

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Surjasan Ilijas
Jabatan : Direktur, PT. Mega Andalan Kalasan
Alamat : Gran Rubina Business Park Lt. 22 C
Komp. Rasuna Epicentrum
Jl. H.R. Rasuna Said - Jakarta12940

Selaku Produsen Peralatan / Produk "MAK Hospital Equipment" dengan ini menunjuk kepada :

PT. POLARIS ALKES STARINDO
Jl. Gunung Sahari Raya 12-G
JAKARTA PUSAT

Sebagai **EXCLUSIVE DISTRIBUTOR DI INDONESIA** untuk Memasarkan, Menjual, Menyalurkan, serta memberikan Pelayanan Purna Jual Produk MAK Hospital Equipment.

Untuk itu kami menjamin sepenuhnya bahwa :

1. Peralatan yang ditawarkan adalah 100% baru .
2. Pemasangan unit/alat sampai berjalan dengan baik oleh tenaga teknisi kami.
3. Pelayanan Purna Jual dengan jaminan ketersediaan suku cadang selama 5 (lima) tahun.
4. Garansi selama 3 (tiga) tahun untuk peralatan tersebut diatas.

Surat Penunjukan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak surat ini dikeluarkan.

Demikianlah Surat Penunjukan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya agar yang berkepentingan menjadi maklum adanya

Jakarta, 21 Oktober 2020

PT Mega Andalan Kalasan

PT MEGA ANDALAN KALASAN
KABUPATEN KULON PRONG
Jl. H.R. Rasuna Said No. 22 C
KOMP. RASUNA EPICENTRUM
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta
Indonesia 12940

Surjasan Ilijas
Direktur

PT MEGA ANDALAN KALASAN

MARKETING OFFICE

Gran Rubina Business Park Lt. 22C,
Komp. Rasuna Epicentrum,
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta,
Indonesia 12940

t (+62) 21 - 837 00 555
f (+62) 21 - 837 00 335

FACTORY

Jl. Tanjung Tirta 34,
Tirtomartani km 13,
Yogyakarta, Indonesia 55571

t (+62) 274 - 497 068
f (+62) 274 - 496 276

Nomor : 094/PAS-PV/VIII/2022
Hal : Penawaran Harga
Lampiran : Brosur

Jakarta, 24 Agustus 2022

Kepada Yth.
Direktur Rumah Sakit Mata Undaan
Jl. Undaan Kulon No.19, Peneleh,
Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur 60274

Dengan hormat,
Bersama surat ini kami PT Polaris Alkes Starindo sebagai agen dan distributor produk alat kesehatan bermaksud memberikan penawaran harga sebagai berikut.

No	Nama Produk	Merk	Type	Harga	Harga Setelah Diskon
1	Emergency Trolley Steel	Wecare	AT05	18,315,000	11,904,750

Adapun ketentuan yang berlaku dalam penawaran harga di atas adalah :

1. Harga sudah termasuk PPN 11%
2. Franko Rumah Sakit Mata Undaan
3. Garansi untuk produk Wecare adalah 3 (tiga) tahun
4. Pembayaran 100% sebelum barang dikirimkan
5. *Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.*

Kami mengharapkan penawaran harga di atas dapat diterima dengan baik. Kami menunggu kabar baik dari Bapak/Ibu dalam waktu dekat ini.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Rahmawan Aldrin
National Sales Manager

CP : Danang Denyawan (0857-4700-0043)

EMERGENCY TROLLEY STEEL

AT05



SPESIFIKASI

Konstruksi

Konstruksi terbuat dari lembaran baja yang diproses dengan teknologi manufaktur terkini.

Bagian/ Terdiri

- 3 laci.
- Laci khusus (terbuat dari lembaran stainless steel).
- Rak atas.

Aksesoris

- Tiang Infus stainless steel, bisa diatur ketinggiannya.
- Dudukan tabung oksigen.
- 3 buah stop kontak, kabel dan jack.
- Panel RJP, di bagian belakang troli.

Castor

Castor 5" + pelindung benturan (bumper).

Finishing

Epoxy powder coating (cat oven).

Berat Produk

± 54 kg.

Dimensi


± (P)785 x (L)600 x (T)1165 mm (keseluruhan).
± (P)500 x (L)500 x (T)725 mm (pada box).

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.



PANEL RJP

Untuk mendukung tindakan RJP sesuai dengan keperluan

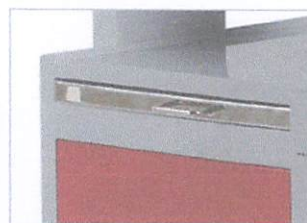

LACI STAINLESS STEEL

Multifungsi untuk penyimpanan alat-alat medis



KUNCI SEGEL

Laci dilengkapi dengan segel untuk penjamin kelengkapan medis yang dibutuhkan



STOP KONTAK


Dilengkapi dengan stop kontak untuk memudahkan penggunaan alat-alat medis selama prosedur perawatan



CASTOR

Dilengkapi dengan castor 5" untuk memudahkan pergerakan trolley

DIMENSI ± (mm)

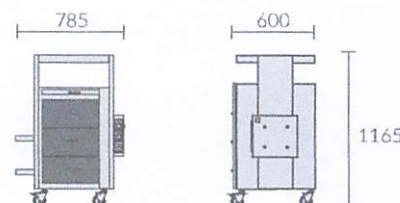

Eff. Date 05-05-2021