

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA PERMINTAAN BARANG MEDIS NON RUTIN

Gedung Rawat Premium.

UNIT : Rawat Inap.

TANGGAL : 22 - 4 - 2022.

NO	NAMA BARANG	MEREK	NO. KATALOG	JUMLAH	PERKIRAAN HARGA	KONDISI BARANG LAMA
1.	NCT 7R	Reichert		1	Rp 310.000	

Menyetujui
Ka. Unit

Mengetahui,
Ka. Waduk Farm Medik
Direktur

Pemohon

Ka. Ins Farmasi

(
)

dr. Sahatya Spm.
(~~dr. Ria Sylvia, SpM~~)

(*very well*)

(Intan Kusumawati)

LEMBAR DISPOSISI

TGL TERIMA	:	14 Januari 2022
NOMOR ARSIP	:	045/UM/01/2022
SIFAT	:	BIASA
NOMOR SURAT	:	-
PENGIRIM	:	KA INSTALASI RAWAT JALAN DAN LASIK
TGL SURAT	:	14 Januari 2022
PERIHAL	:	PENGAJUAN PEMBELIAN ALAT NCT (REICHERT) UNTUK UNIT LASIK DAN RAWAT JALAN
DIREKTUR	:	TANGGAL : 21 January 2022 CATATAN : Mohon dijadwalkan untuk diskusi direksi dan Bag Keuangan hari ini pk 12.30. Mohon sirkulasi Wadir YanMed, Wadir KUSDM dan Kabag Keuangan
SUB BAGIAN TATA USAHA	:	TANGGAL : 21 January 2022 CATATAN : untuk diketahui dok
UMUM DAN KEUANGAN	:	TANGGAL : 22 January 2022 CATATAN : OK
SUB BAGIAN TATA USAHA	:	TANGGAL : 27 January 2022 CATATAN : mohon arahan selanjutnya dok
UMUM DAN KEUANGAN	:	TANGGAL : 27 January 2022 CATATAN : pembuatan 2 PO 1. PO NCT Ready Stock 1 buah ; kedatangan february ; pembayaran 2x 30 hari setelah instalasi alat, Maret 50%, April 50% 2. PO NCT Indent 2 buah ; DP 30% february ; kedatangan Mei ; pembayaran 2x 30 hari setelah instalasi alat, Juni 35%, Juli 35%
SUB BAGIAN TATA USAHA	:	TANGGAL : 27 January 2022 CATATAN : untuk diketahui
INSTALASI FARMASI	:	TANGGAL : 27 January 2022 CATATAN : untuk diketahui terkait mekanisme pembayaran
BAGIAN KEUANGAN	:	TANGGAL : 27 January 2022 CATATAN : Untuk disiapkan
TGL PENYELESAIAN	:	27 Januari 2022

PT. OPHTHALINDO JAYA

MGK Kemayoran Kantor Blok A No. 8-9,
 Jalan Angkasa Kav B-6, Kota Baru, Kemayoran,
 Jakarta Pusat 10610 – Indonesia
 +62-21 2937 1382 [Phone] | +62-21 2937 1381 [Fax] | +62 8211 0628 189
 info@ophthalindo.com | www.ophthalindo.com

**OPHTHALINDO**

No : 0339-21-SUB-PM-S1
 Perihal : Penawaran Harga Spare Part

Surabaya, 24 November 2021

Kepada Yth.
Direktur
RS Mata Undaan
Jl. Undaan Kulon No,19, Peneleh
Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60274
Telp. 031 - 5343806

Dengan hormat,

Terima kasih atas kerjasamanya selama ini antara **RS Mata Undaan** Dengan **PT. Ophthalindo Jaya**. Sehubungan dengan adanya intruksi dari kantor pusat terkait perihal harga untuk tahun 2021, maka dengan ini akan kami sampaikan beberapa perubahan harga yang terjadi. Semoga kerjasama yang terjalin antara ke dua belah pihak akan semakin membawa kebaikan

No.	Brand	No. Ijin Edar (AKL)	Nama Barang
1	Reichert ; USA MIIS-E#CR100CHINREST TABLE01	21201028327	Reichert 7CR Auto Tonometer with Corneal Response Technology - 16060SET Terdiri : 1. UNIT REICHERT 7 CR 2. Body Cover 3. User Guide 4. Power Cable 5. Positioning Guide 6. Printer Paper 7. Spare Head Pad Chinrest Electric Table
Harga : Disc. 40% : Harga Setelah Disc :			Rp. 509.000.000,- Rp. 203.600.000,- Rp. 305.400.000,-
2	Reichert ; USA TABLE01	11201121271	OptoChek Plus Auto Refractor / Keratometer - 15170 Terdiri : 1. OPTOCHECK UNIT ARK 2. Kabel power 3. Quick reference guide 4. Chinrest paper 5. Chinrest paper pins 6. Printer Paper 7. Fuse 8. Verification model eye Electric Table
Harga : Disc. 40% : Harga Setelah Disc :			Rp. 380.000.000,- Rp. 152.000.000,- Rp. 228.000.000,-

PT. OPHTHALINDO JAYA

MGK Kemayoran Kantor Blok A No. 8-9,
Jalan Angkasa Kav B-6, Kota Baru, Kemayoran,
Jakarta Pusat 10610 – Indonesia
+62-21 2937 1382 [Phone] | +62-21 2937 1381 [Fax] | +62 8211 0628 189
info@ophthalindo.com | www.ophthalindo.com



OPHTHALINDO

No : 0339-21-SUB-PM-S1

Surabaya, 24 November 2021

Ketentuan :

1. Harga dalam mata uang Rupiah dan sudah termasuk PPN 10%.
2. Penawaran Harga berlaku selama 3 bulan sejak surat ini dikeluarkan.
3. Garansi 1 (satu) tahun, bukan atas human error, tidak termasuk Force Majure.
4. Pembayaran via transfer, dengan janga waktu 30 hari setelah barang terkirim..
5. Barang Indent
6. Franko Surabaya.

Demikian informasi ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Ophthalindo Jaya

OPHTHALINDO
Sales Sub Dept

Agung Kristantyo. B
Product & Sales Manager

Contact Person :

Bapak Agung 0811 3255 593

PT. OPHTHALINDO JAYA

MGK Kemayoran Kantor Blok A No. 8-9,
Jalan Angkasa Kav B-6, Kota Baru, Kemayoran,
Jakarta Pusat 10610 - Indonesia

+62-21 2937 1382 | +62-21 2937 1381 [Fax] | +62 8211 0628 189
info@ophthalindojaya.com | www.ophthalindojaya.com



OPHTHALINDO



Reichert 7CR

Auto Tonometer + Corneal Response Technology™

The Glaucoma Tonometer.

Reichert[™]
TECHNOLOGIES
Advancing Eye Care. Preserving Sight.™

CAUSE WE CARE

PT. OPHTHALINDO JAYA

MGK Kemayoran Kantor Blok A No. 8-9,
Jalan Angkasa Kav B-6, Kota Baru, Kemayoran,
Jakarta Pusat 10610 - Indonesia

+62-21 2937 1382 | +62-21 2937 1381 [Fax] | +62 8211 0628 189
info@ophthalindojaya.com | www.ophthalindojaya.com



OPHTHALINDO

Reichert 7CR Auto Tonometer + Corneal Response Technology™

Specifications

Catalog Number	16060
Dimensions	19.75" h x 10.5" w x 14" d (50.2 x 26.7 x 35.6 cm)
Weight	23 lbs (10.4 kg)
Voltage	100/240 VAC
Frequency	50/60 Hz
Measurement Range	7 - 60 mmHg (ISO 8612 tonometer standard)





PT. OPHTHALINDO JAYA

MGK Kemayoran Kantor Blok A No. 8-9,
Jalan Angkasa Kav B-6. Kota Baru, Kemayoran,
Jakarta Pusat 10610 - Indonesia

+62-21 2937 1382 | +62-21 2937 1381 [Fax] | +62 8211 0628 189
info@ophthalindojaya.com | www.ophthalindojaya.com



OPHTHALINDO



OptoChek™ Plus Auto Refractor + Keratometer

The all-new Reichert® OptoChek™ Plus Auto Refractor + Keratometer is thoughtfully designed and packed with powerful features that streamline the pre-test process for all eye care practitioners, making it a welcomed addition to our renowned family of lane and refraction equipment. The OptoChek™ Plus is fast, simple, and best of all, allows you to easily obtain important pre-test measurement information at the start of your exam quickly and accurately.

Slim and Elegant Design

Featuring a slim, ergonomic profile and compact footprint, the OptoChek™ Plus saves valuable space and fits seamlessly into existing pre-test rooms and office settings. It even has a small storage compartment located on its top for convenient stowing of essential supplies and accessories.

CAUSE WE CARE

PT. OPHTHALINDO JAYA

MGK Kemayoran Kantor Blok A No. 8-9,
Jalan Angkasa Kav B-6, Kota Baru, Kemayoran,
Jakarta Pusat 10610 - Indonesia

+62-21 2937 1382 | +62-21 2937 1381 [Fax] | +62 8211 0628 189
info@ophthalindojaya.com | www.ophthalindojaya.com



OPHTHALINDO

OptoChek™ Plus

Catalog Number: 15170 Auto Refractor + Keratometer

Specifications:

Refractive Measurement Range

Sphere	-30D to +22D (in case VD=12) (Step: 0.12/0.25D)
Cylinder	0 to ± 10D (Step: 0.12/.25D)
Axis Angle	1 to 180° (Step: 1°)

Keratometry Refraction Range

Radius of Curvature	5.0 to 10.0 mm (Step: 0.01 mm)
Corneal Power	33.75 to 67.5D (Corneal refractive n=1/3375) (Step: 0.12/0.25D)
Degree of Corneal Astigmatism	0 to ±10D (Step: 0.12/0.25D)
Axis Angle	1 to 180° (Step: 1°)

Refraction

Pupil Diameter Measurement Range	2.0 to 8.5 mm (Step: 0.01 mm)
PD Measurement Range	85 mm (Step: 1 mm)
Vertex Distance	0, 10, 12, 13.5, 15 mm
Minimum Pupil Diameter	2.0 mm
Printer	Thermal line printer (Paper width: 58 mm)
Internal Monitor	145 mm (5.7 inches) color LCD monitor

Positioning Range of Measurement Unit

Front/ Back	±22 mm
Right/ Left	±43 mm
Up/ Down	±17 mm
Vertical Adjustment Range of Chinrest	±30 mm
Output	RS-232C

Size


Weight, Unpacked	28.1 Kg (12.8 lbs)
Height	46.4 cm (18.3 in.)
Width	22.9 cm (9.0 in.)
Depth	42.9 cm (16.9 in.)

Electrical

Input Power	100 to 240V @ 50/60Hz, 60 VA
Fuse	T2AL 250 VAC
Bluetooth Power Source	5 VDC ± 5% @ 200 mA (typical)
Power Saving Function	OFF, 3, 5, 10 min. (switchable)

OptoChek™ Plus

Auto Refractor + Keratometer



FORM EVALUASI KLINIS

Nama Produk : Auto Tono Meter

Tanggal : 13 Januari 2022

Nama Dokter : ^{Referensi} Selpi Septian

Nama Organisasi/RS/Klinik : RS. Mata Undaan (Poliklinik)

Jenis>Nama Operasi :

Merek Produk yang sedang dipakai : Reschert 7^{CR}

Tolong diberikan nilai atas produk kami :

(5=Sangat Bagus, 4=Bagus, 3=Sedang, 2=Kurang, 1=Sangat Kurang)

- a. Kenyamanan penggunaan (5) / 4 / 3 / 2 / 1
- b. Kemudahan Penggunaan 5 / (4) / 3 / 2 / 1
- c. Kualitas Produk 5 / (4) / 3 / 2 / 1
- d. Kesan Keseluruhan (5) / 4 / 3 / 2 / 1

Komentar atau Saran jika ada.

Terima kasih atas bantuannya dalam melakukan evaluasi Produk kami.



Silahkan menghubungi kami di:
PT. OPHTHALINDO JAYA
email: info@ophthalindojaya.com
MGK Kemayoran Kanto Blok A No. 7,
Jakarta Pusat 10610
Tel: +62-21-29371382, Fax: +62-21-29371381

Handwritten signature and date:
13/01/22

Tanda Tangan Dokter

Handwritten signature:
Selpi Septian

FORM EVALUASI KLINIS

Nama Produk : Auto taro Meter Tanggal : 13 Januari 2022

Nama Dokter : ^{Refraksionis} Anggoro Rubiyanto

Nama Organisasi/RS/Klinik : RS. Mak Labaan (Poliklinik)

Jenis>Nama Operasi :

Merek Produk yang sedang dipakai : Reichert 7 ce.

Tolong diberikan nilai atas produk kami :

(5=Sangat Bagus, 4=Bagus, 3=Semang, 2=Kurang, 1=Sangat Kurang)

- a. Kenyamanan penggunaan 5 / 4 / 3 / 2 / 1
- b. Kemudahan Penggunaan 5 / 4 / 3 / 2 / 1
- c. Kualitas Produk 5 / 4 / 3 / 2 / 1
- d. Kesan Keseluruhan 5 / 4 / 3 / 2 / 1

Komentar atau Saran jika ada.

Hasil lopee masih terlalu tinggi.

Kadang lopeg hasil terlalu rendah

Terima kasih atas bantuannya dalam melakukan evaluasi Produk kami.



Silahkan menghubungi kami di:

PT. OPHTHALINDO JAYA


email: info@ophthalindojaya.com


MGK Kemayoran Kanto Blok A No. 7,

Jakarta Pusat 10610

Tel: +62-21-29371382, Fax: +62-21-29371381

Tanda Tangan Dokter

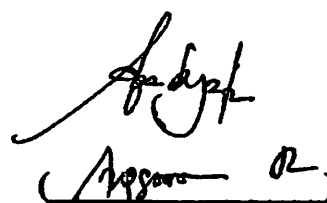

Mengetahui,
 13/22
13/01

FORM EVALUASI KLINIS

Nama Produk : Auto Pano Meter Tanggal : 13 / Januari / 2022

Nama Dokter : Hendrawati, RD

Nama Organisasi/RS/Klinik : RS. Mata Onsan (Praktik)

Jenis>Nama Operasi :

Merek Produk yang sedang dipakai : Reichert 7^{ce.}

Tolong diberikan nilai atas produk kami :

(5=Sangat Bagus, 4=Bagus, 3=Sedang, 2=Kurang, 1=Sangat Kurang)

- | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|
| a. Kenyamanan penggunaan | 5 | / | (4) | / | 3 | / | 2 | / | 1 |
| b. Kemudahan Penggunaan | 5 | / | (4) | / | 3 | / | 2 | / | 1 |
| c. Kualitas Produk | 5 | / | (4) | / | 3 | / | 2 | / | 1 |
| d. Kesan Keseluruhan | 5 | / | (4) | / | 3 | / | 2 | / | 1 |

Komentar atau Saran jika ada.

Kita harus menuliskan hasil NCT yg mana

apabila hasil IOP_{ce} dan IOP_g bedanya jauh ??

ex: hasil IOP_{ce} tinggi sedang IOP_g rendah ??

Terima kasih atas bantuannya dalam melakukan evaluasi Produk kami.



Silahkan menghubungi kami di:

PT. OPHTHALINDO JAYA

email: info@ophthalindojaya.com

MGK Kemayoran Kanto Blok A No. 7,

Jakarta Pusat 10610

Tel: +62-21-29371382, Fax: +62-21-29371381

Tanda Tangan Dokter

Hendra W., R-D¹

()

measrabu,
13/01/22