

Surabaya, 04 Juli 2024

Nomor : 010/RSMU/PSP-MEDIS/VII/2024  
Lampiran : 4 Lembar  
Perihal : Pembelian Sparepart Mesin Srerilisator CSSD (Gasket DGM)

Yth. **GM Umum & SDM Rumah Sakit Mata Undaan**  
Surabaya

Dengan hormat,

Menindaklanjuti laporan kerusakan pada mesin autoklaf Merk DGM di CSSD unit Kamar Bedah, bersama ini kami Manager PSPRS mengajukan biaya pembelian part dengan rincian harga dari 2 produsen terlampir.

Sebagai informasi bahwa dari pihak Supplier Mesin DGM sudah tidak menjual part tersebut dan disarankan ke Pihak ke-3, mengingat penggantian Gasket yang hampir rutin per 6 bulan (2x per tahun) maka kami mencari beberapa alternatif produsen dengan pertimbangan kualitas dan harga.

Demikian surat permohonan kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Manager Pemeliharaan Sarana dan Prasarana



Sudarto

Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id

Urgent 



Surabaya, 22 Mei 2024

Nomor : 1258/S.Pmb/Nus.06.04/V/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan

Kepada Yth,  
Direktur RS Mata Undaan  
di  
Tempat

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan adanya kendala produksi door gasket dari pabrikan untuk alat DGM yang ada di ruang CSSD RS Mata Undaan. Maka kami PT Rajawali Nusindo selaku distributor mohon maaf belum dapat melayani atas pesanan sparepart tersebut, hingga waktu yang belum dapat kami tentukan.

No	Nama Barang	Jumlah
1	Door Gasket	2

Demikian surat pemberitahuan kami sampaikan, atas perhatian dan Permaklumannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**Rajawali Nusindo**  
  
Cabang Surabaya  
( R Untorojoyo Tjokronegoro )  
Kepala Cabang

Surabaya, 06 November 2023

Nomor : 1367/RSMU/DIR/XI/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Pemesanan *Spare Part Gasket* Mesin DGM

Yth. **Pimpinan PT. Rajawali Nusindo**  
di Tempat

Dengan hormat,  
Berdasarkan surat penawaran harga nomor: 2214/S.Pnw/Nus.06.04/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023, maka kami setuju dengan penawaran tersebut, sebagai berikut :

Nama Produk	Qty	Harga Satuan	Jumlah
<i>Door Gasket</i>	2 Unit	Rp. 9.360.000.-	Rp. 18.720.000.-
Total			Rp. 18.720.000.-

Keterangan :

- Harga belum termasuk PPN 11%

Demikian yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
Wakil Direktur Umum dan Keuangan, 



dr. Fakh Nur Salimi Latief, S.H.

Sidoarjo, 06 Maret 2024

Hal : Penawaran harga  
No. : 01.SPH.RS.144.060624  
Lamp : -

Kepada Yth.

**RS Mata Undaan**

Jl. Undaan Kulon No.19, Peneleh, Kec. Genteng  
Kota Surabaya - Jawa Timur 60274

Dengan hormat,

Berdasarkan permintaan harga sparepart DGM, maka kami sampaikan informasi penawaran harga sebagai berikut:

No.	Nama Barang/Jasa	Qty	sat.	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Door gasket	2	pcs	9.000.000	18.000.000
				Sub Total	18.000.000
				PPN 11%	1.980.000
				<b>Jumlah Total</b>	<b>Rp 19.980.000</b>

**Catatan:**

- Sudah termasuk PPN 11%
- Minimal DP 30% dari sub total
- Ketersediaan barang maksimal 14 hari setelah surat pesanan kami terima

**SYARAT & KETENTUAN:**

- Apabila ada kebutuhan tambahan sparepart lainnya, maka akan dibuatkan penawaran harga terpisah
- Pembayaran transfer ke rekening kami dibawah ini:  
Nama Bank : BANK MANDIRI | KCP Sidoarjo Pahlawan  
Nomor Rekening : 141-00-2167976-6  
Nama Pemilik Rekening : CV AFSA TECH

Demikian penawaran harga ini kami sampaikan, jika ada pertanyaan silahkan hubungi kami di No. telp & Whatsapp : **081299540403**. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,  
CV. AFSA TECH







**AFSA TECH**  
Repair & Maintenance Service  
**SUDARYATNO**

*(Bagi pelanggan yang TIDAK DAPAT mengeluarkan Surat Pemesanan, DIWAJIBKAN menandatangani bagian dibawah ini sebagai konfirmasi pembelian kepada CV. AFSA TECH)*

[Tanda tangan, Tanggal & Stempel Instansi/RS/Klinik/PT]

Nama Penanggung Jawab :  
Nama Instansi/RS/Klinik/PT : RS Mata Undaan - Surabaya

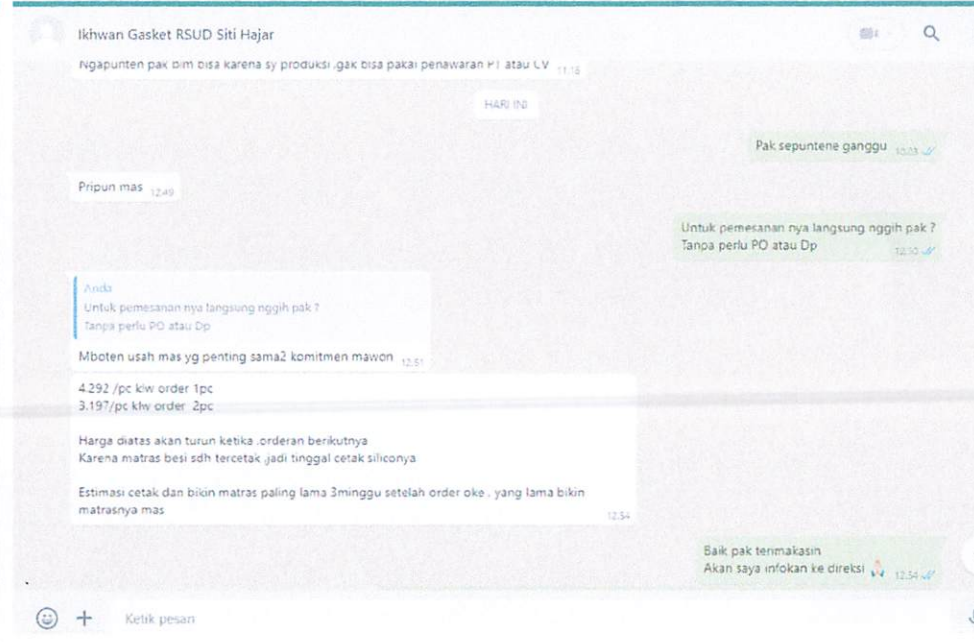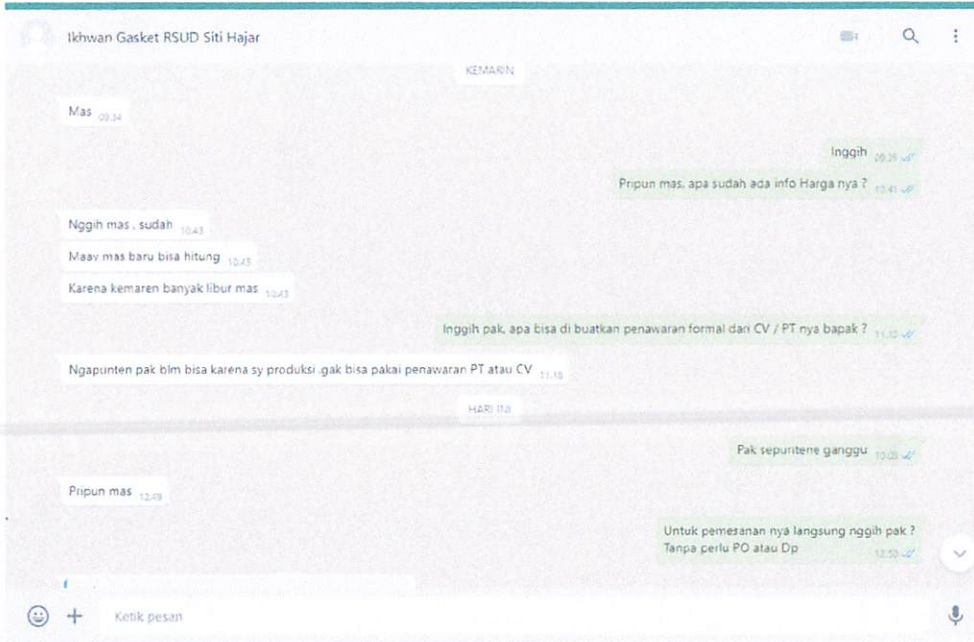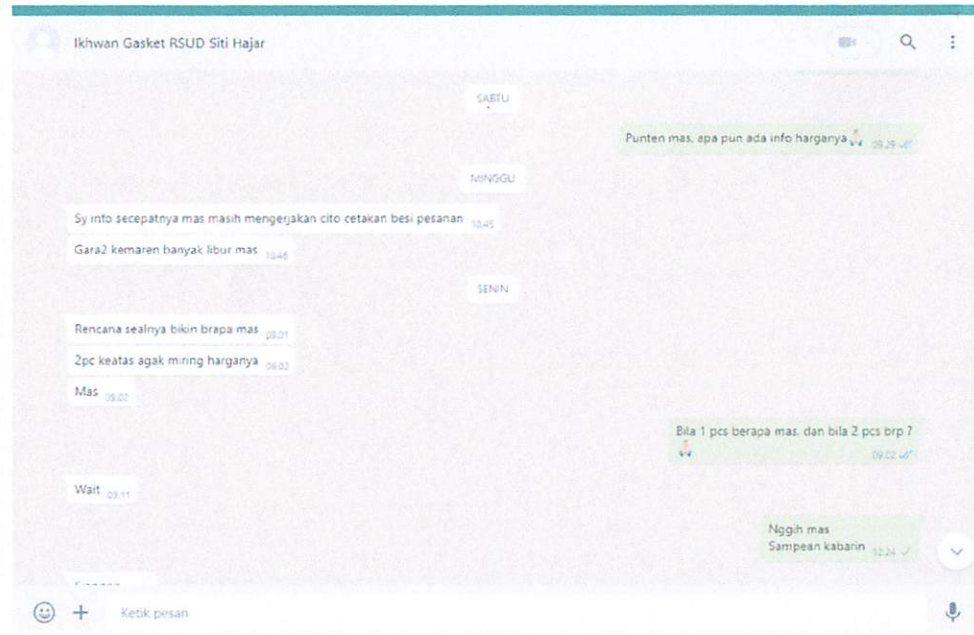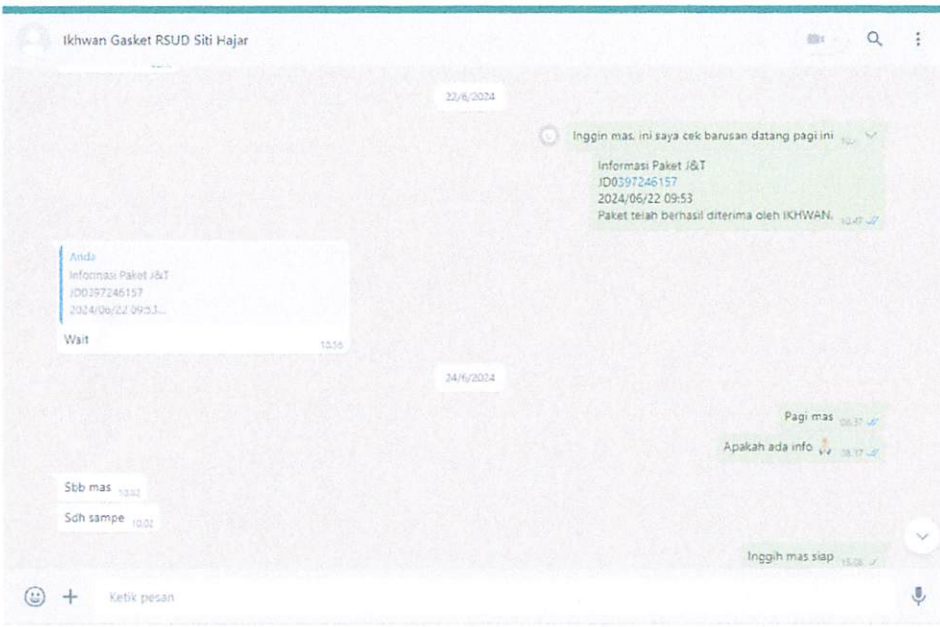

Pelaksanaan 2 pcs Rp. 7.500.000